

扫描起始页与页数


为方便广大用户更方便的使用 2829X 系列变压器扫描测试系统，目前在 2829X 系列仪器下增加扫描起始页与页数功能。

该功能主要为了方便用户在选中的几个页面中，进行偏差扣除以及参数测试。

2014 年 7 月 24 日及其以后所有版本的 2829X 系列仪器均包含此功能。

在<变压器编号>界面，选择工具按键，进入<工具>界面。将光标旋至扫描起始页面，输入数字确定扫描起始页，将光标旋至扫描页面数量，输入数字确定从起始页开始共需测试的页面数。

如下图所示，扫描起始页 A3，扫描页面数量 03，即表示测试页面为 A3, A4, A5，共 3 页。

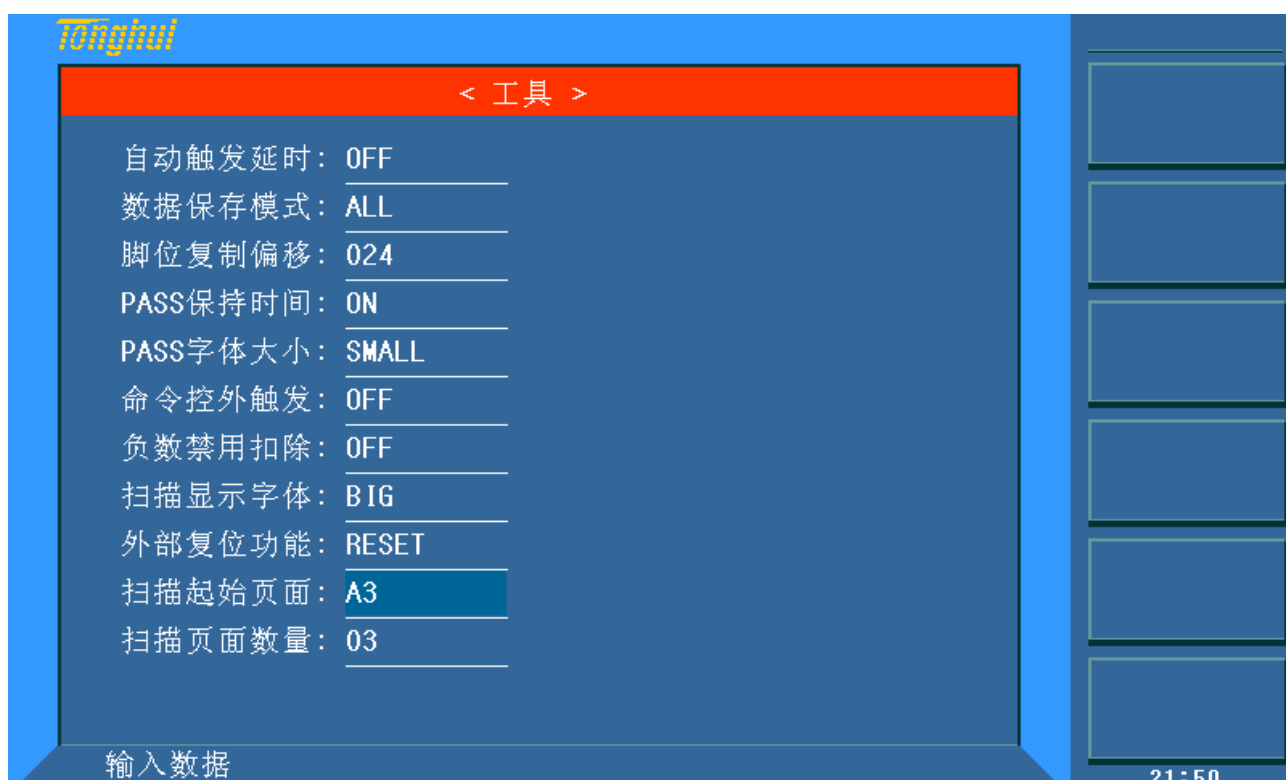

注：在扫描起始页面，输入数字 0 即为关闭此项功能，扫描页面数量也将不起作用。默认为关闭。